


Blutentnahme Kapillär – Plasma, Serum

Microtainer® (23, 24)

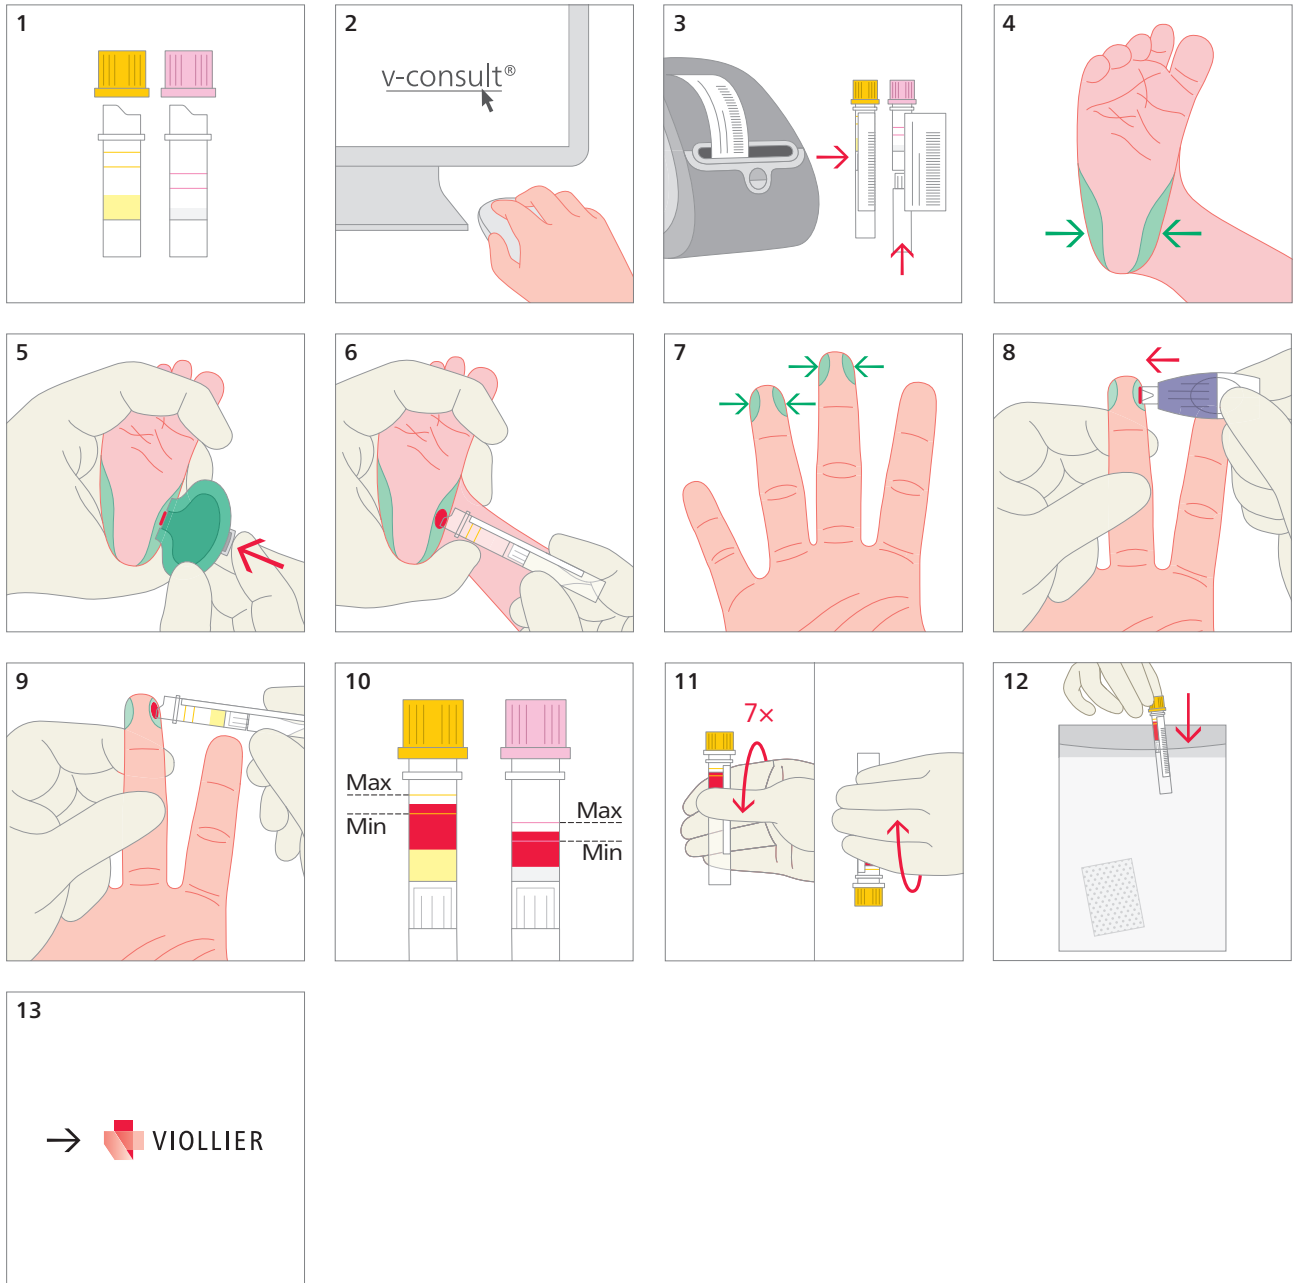

- | | |
|-------|--|
| 3 | Aufgesteckte Verlängerungshülse ermöglicht das Aufkleben der v-consult®-Etikette |
| 4 / 7 | Korrekte Entnahmestelle beachten |
| 12 | Versand immer in Versandhülle |

Versandmaterial:

Bitte mit Namen, Vornamen und Geburtsdatum des Patienten beschriften